

NONIN 9600 Avant

Digitální pulsní oxymetr

Návod k použití



OBSAH	str.
1. Průvodce symboly.....	3
2. Preventivní bezpečnostní informace.....	5
3. Použití digitálního pulsního oxymetru Avant 9600.....	6
3.1 Seznámení s přístrojem.....	6
3.2 Instalace baterií.....	6
3.3 Zapnutí přístroje.....	7
3.4 Ověření provozu.....	7
3.5 Displeje, ukazatele a ovládací prvky.....	8
3.6 Další funkce.....	10
3.7 Přepínače přístroje Avant 9600.....	13
3.8 Komunikační funkce.....	14
3.9 Ošetřování a údržba.....	15
4. Alarmsy a limity.....	15
4.1 Alarmsy vysoké a střední priority.....	15
4.2 Informační tóny.....	16
4.3 Kódy chyb.....	16
4.4 Přehled alarmů.....	16
4.5 Nastavení a změny hlasitosti a limitů alarmů.....	16
4.6 Deaktivace alarmů.....	17
4.7 Blokované a neblokované alaromy.....	17
4.8 Režim Patient security.....	17
5. Komunikace.....	18
5.1 Paměť.....	18
5.2 Použití softwaru nVision.....	18
5.3 Výstup dat v reálném čase.....	19
6. Teorie provozu.....	19
7. Specifikace.....	20
8. Díly a příslušenství.....	22
9. Servis a údržba.....	23
10. Průvodce možnými problémy.....	24

Přístroj nevyhazujte do komunálního odpadu!!

Dle zákona č. 106/2005 je výrobce veden v Seznamu výrobců elektrozařízení MŽP pod evidenčním číslem **00508/05-ECZ, „8/05“**.

KAPITOLA 1. Průvodce symboly



Pozor: Před použitím si přečtěte návod na použití



Izolace pacienta od nebezpečí elektrických šoků



CE značka označuje soulad se směrnicí číslo 93/42/EEC týkající se zdravotnických zařízení



Sériové číslo (umístěno pod zadním krytem)



Výstup pro napájení (na zadní části přístroje)



Alarm (na zadní části přístroje)

%SpO₂

Displej SpO₂



Displej srdeční frekvence



Tlačítko ON/STANDBY



Tlačítko času a data



Tlačítko hlasitosti



Tlačítko ztišení alarmu



Tlačítko limitů



Tlačítko plus



Tlačítko minus

Symboly displeje



Číselný LED



LED hlavního alarmu



LED pulsů



LED senzoru oxymetru



Sloupcový graf pulsů

- Displej horního limitu alarmu
- Displej spodního limitu alarmu



LED ztišení alarmů



LED času



LED měsíce



LED dne



LED roku



LED hlasitosti pulsů



LED hlasitosti alarmů



LED AC adaptér



LED baterií

Kapitola 2.

Preventivní bezpečnostní informace

VAROVÁNÍ

- Nepoužívejte přístroj v explosivním prostředí
- Měřené hodnoty mohou být ovlivněny použitím jiného elektronického přístroje.
- Používejte pouze příslušenství a senzory NONIN, jejichž nastavení a technické parametry jsou v souladu s přístrojem Avant 9600. Použitím příslušenství jiného výrobce můžete způsobit nepřesnosti měření.
- Nepoužívejte zničené senzory.
- Nepoužívejte přístroj v blízkosti vody či jiné tekutiny, je-li napájen ze sítě el. proudu
- Používejte Avant 9600
- Komunikační funkce přístroje Avant 9600 nesmí nahrazovat funkci alarmů.
Zvukové a vizuální alarmy monitoru, společně s klinickými syndromy pacienta jsou pro zdravotnický personál hlavním zdrojem informací o jeho zdravotním stavu.

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ


- Před použitím pečlivě přečtěte uživatelské informace týkající se senzorů.
- Kardiovaskulární či jiná intravaskulární barviva mohou ovlivnit přenos měření SpO₂.
- Senzory oxymetru nemusí správně fungovat na, díky špatné krevní cirkulaci, studených částech těla. V tomto případě zahřejte prsty pro její zlepšení, nebo senzor přemístěte.
- Minimalizujte pohyb pacienta.
- Laky na nehty a umělé nehty mohou snížit prostupnost světla a tím ovlivnit přesnost měření. Před začátkem měření proto tyto nedostatky odstraňte.
- Pečlivě zkontrolujte jestli umístění senzoru nejlépe vyhovuje potřebám měření. Citlivost pacienta na senzory NONIN záleží na jeho aktuálním zdravotním stavu a citlivost pokožky.
- Ušní senzor a reflexní senzor nejsou určeny pro děti. Jejich nastavení neodpovídá dětským hodnotám.
- Přístroj ani jeho části nemámejte do tekutiny.
- Nepoužívejte hrubé ani agresivní čistící prostředky.
- Baterie mohou vytéci či explodovat, jsou-li nesprávně používány. Proto nepoužívejte nikdy dohromady nové a staré baterie a měňte je vždy společně.
- Nebudete-li přístroj používat po dobu delší než 1 měsíc, baterie vyjměte.

Kapitola 3.


Použití digitálního pulsního oxymetru Avant 9600

3.1 Seznámení s přístrojem


Nonin Avant™ 9600 digitální pulsní oxymetr je přenosný, stolní přístroj určený pro současné měření, zobrazování a zaznamenávání hladiny nasycení krve kyslíkem (SpO_2) a tepové frekvence, pro děti i dospělé doma, v nemocnicích ale i na ambulancích.

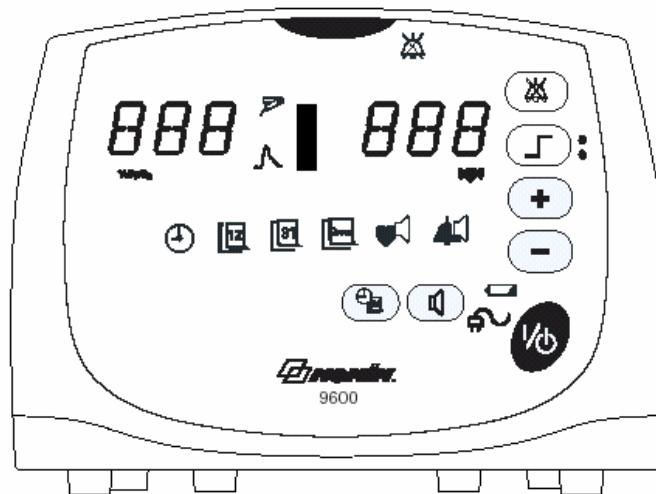

3.2 Instalace baterií

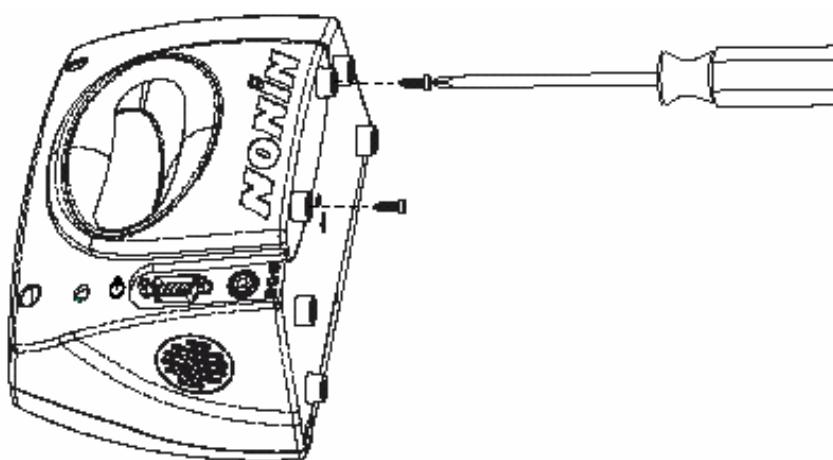

Obrázek sejmání krytu baterie

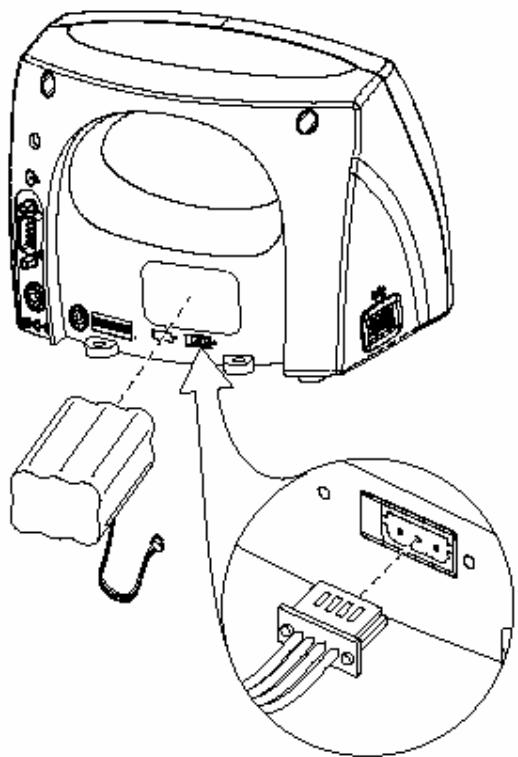

1. Vyšroubujte dva malé šroubky na spodku zeleného krytu baterií.

2. Opatrně sejměte kryt baterií tahem.

3. Pokud je potřeba, vyndejte staré baterie a řádně likvidujte.

4. Vložte novou sadu baterií (viz obrázek). **Správné umístění baterií je nezbytnou podmínkou funkce přístroje.**

5. Pečlivě nainstalujte zpět kryt baterií. Nepoužívejte síly. Kryt musí lehce zapadnout na své místo.

6. Jemně našroubujte zpět šroubky. Nadměrně nedotahujte.

7. Zapněte přístroj. Musí proběhnout test. Jestliže se přístroj nezapne, použijte AC adapter k dobití nových baterií.

8. Jestliže se přístroj ani poté nezapne, znova nainstalujte baterie.

Poznámka : Indikace kapacity baterií nebude funkční pokud se nově vložené baterie alespoň jedenkrát úplně nenabijí.

3.3 Zapnutí přístroje

1. Stlačte tlačítko ON/STANDBY.

2. Prověřte, zda všechny displeje svítí a zda přístroj 3x pípne.

Poznámka: Když se přístroj zapne, a senzor SpO2 není k přístroji připojen, v displeji SpO2 se nic nezobrazí.

3.4 Ověření provozu

Po zapnutí přístroje proběhne v několika krocích test. Prověřte, zda všechny displeje svítí, přístroj musí třikrát pípnout. Jestliže některý displej nesvítí (s výjimkou displeje AC adapter) nepoužívejte přístroj.

Abyste prověřili, zda přístroj řádně funguje, je důležité sledovat výsledky měření na displejích. Použijte následující postup.

1) Ověřte, aby byl přístroj zapnut a všechny senzory k přístroji připojeny.

2) Připojte senzor na prst.

3) Ověřte zda je zobrazeno správné čtení SpO2 na displeji, že se objeví hodnoty srdeční frekvence, a zda sloupcový graf je aktivní. Nesprávné čtení SpO2 a srdeční frekvence mohou být zapříčiněny z různých důvodů. Senzor není správně umístěn, pacientův puls je slabý, v okolí je rozptýleno silné světlo, nehet prstu je nalakován nebo je umělý, prst je vlhký nebo mokrý, ...

3.5 Displeje, ukazatele a ovládací prvky

Displeje

Displej SpO₂

Světlo-emitující diody (LED) v horním levém rohu číslicově zobrazují nasycení krve kyslíkem v %. (symbol %SpO₂).

Displej srdeční frekvence

Displej srdeční frekvence je spodní číslicový displej v horním levém rohu model 2120 (označeno symbolem ♥). Tento tříčíslicový displej ukazuje hodnotu srdeční frekvence v pulsech za minutu.

Numerické LED



Číselné LED zobrazují výsledky měření %SpO₂, srdeční frekvence stejně jako hlasitost, datum a čas.

Za normálních podmínek svítí tříčíslicový displej zeleně. Při vysoké prioritě alarmů (pacienti) jsou hodnoty zobrazovány červeně a blikají frekvencí 2Hz. Při střední prioritě alarmů (přístroj) jsou hodnoty zobrazovány žlutě a blikají frekvencí 0,5 Hz. Tříčíslicové displeje také žlutě (neblikají) zobrazují meze alarmů.

Ukazatele a ikony

LED hlavního alarmu



Displej hlavního alarmu vizuálně zobrazuje stavy alarmů. Vysoká priorita se projeví červeným světlem, které bliká frekvencí 2Hz. Střední priorita se zobrazí žlutou barvou, která bliká frekvencí 0,5 Hz.



LED pulsů

Tento displej blikáním indikuje špatné pulsy. Jestliže přístroj zjistí více špatných pulsů (přibližně v po 10 sekundách) tento displej svítí trvale.



LED senzoru oxymetru

Tento displej indikuje stav, kdy je senzor odpojen od pacienta, kdy nesprávně snímá, kdy nebo nebyl na pacienta připojen správně.



Sloupcový graf pulsů

Tento osmisegmentový trojbarevný graf indikuje intenzitu pulsů zjištěných oxymetrem. Graf mění barvy v závislosti na intenzitě pulsů.

Zelená = dobrý signál pulsů

Jantarová/žlutá = krajní, mezní signál pulsů

Cervená = nízký signál pulsů, alarm vysoké priority

Sloupcový graf také indikuje procentní kapacitu baterií v 12% přírůstcích v zelené barvě a podíl spotřeby ve žluté barvě.



LED ztišení akustiky alarmů

Žlutý displej blikáním indikuje stav, kdy je zvukový alarm dočasně vypnut (po dobu dvou minut). V případě, kdy svítí trvale, je hlasitost zvukového alarmu nastavena na nulu.



LED času, měsíce, dne a roku

Žlutá LED indikuje stav, kdy lze měnit nastavení všech těchto hodnot pomocí tlačítek plus (+) a minus (-).



LED hlasitost pulsů

Žlutá LED indikuje stav, kdy lze měnit nastavení hlasitosti pulsů pomocí tlačítek plus (+) a minus (-).



LED hlasitost alarmů

Žlutá LED indikuje stav, kdy lze měnit nastavení hlasitosti alarmů pomocí tlačítek plus (+) a minus (-).



LED AC adapteru

Tento zelený displej indikuje zda AC adapter je nebo není připojen do přístroje.



LED baterií

Žlutá LED indikuje blikáním krajní kapacitu baterie. Svítí-li trvale, je třeba baterii nabít.

Indikace kapacity baterií nebude funkční pokud se nově vložené baterie alespoň jedenkrát úplně nenabijí.

Ovládací tlačítka



Tlačítko ON/STANDBY

Toto tlačítko přepíná přístroj mezi ON a STANDBY módy. Stlačením tlačítka se model 9600 zapne. Stlačením tohoto tlačítka na dobu delší než 1 sekundu se přístroj vypne.

V režimu Patient security musí být tlačítko stisknuto alespoň po dobu 5ti sekund.

Krátkým stisknutím tohoto tlačítka (při zapnutém přístroji) se zeleně na 4 vteřiny zobrazí kapacita baterií v procentech, v 12% náruštích.

Tlačítko času / data



Toto tlačítko zobrazuje čas a datum. Rok, měsíc, den, hodina a minuta mohou být nastaveny pomocí tlačítek plus (+) a minus (-).



Tlačítko hlasitosti

Toto tlačítko slouží ke zkонтrolování nebo nastavení hlasitosti tepové frekvence či alarmů podle toho, který příslušný LED displej je právě rozsvícen.

Cyklus tohoto tlačítka je: hlasitost tepové frekvence → alarmů → vypnuto



Tlačítko ztišení akustického signálu alarmů


Stlačením tohoto tlačítka vypnete všechny akustické alarmy po dobu dvou minut.



Tlačítko mezí alarmů a jejich ukazatele

Toto tlačítko zobrazuje horní a spodní meze alarmů měření SpO₂ a srdeční frekvence. Tyto limity mohou být nastavovány tlačítky plus (+) a minus (—). Cyklus tlačítka dovoluje jak zpětně prohlížet nastavení alarmů, tak provádět nastavení nové.

Horní LED displej zobrazuje horní hranici alarmu, dolní displej pak spodní hranici.



Tlačítka plus a minus

Slouží k nastavení hlasitosti alarmů a tepové frekvence, datumu, času a limitů alarmů. Stisknutím jednoho z těchto tlačítek – není-li právě přístroj nastaven v nějakém módu – můžete také nastavit jasnost monitoru.

3.6 Další funkce

Všechny funkce lze rozdělit do tří různých celků:

- Základní funkce
- Funkce nastavení
- Pokročilé funkce

Základní funkce

- Vypnutí a zapnutí přístroje:



Pro zapnutí krátce stiskněte tlačítko ON/STANDBY. Pro vypnutí ho držte nejméně po dobu jedné sekundy. Pokud je přístroj v režimu Patient security, pak po dobu pěti sekund.

- Zkontrolování stavu baterie:




Je-li přístroj v provozu, stiskněte krátce tlačítko ON/STANDBY. Na 4 vteřiny se zeleně zobrazí kapacita baterií v procentech, v 12% nárůstcích.

- Ztlumení zvukových alarmů na 2 minuty:



Stiskněte tlačítko ztišení akustického signálu alarmů. Jeho opětovným stiskem zrušení alarmů deaktivujete.


- Nastavení jasnosti displeje:



Krátce stiskněte tlačítka plus či minus.


Funkce nastavení

- Nastavení hodnot alarmů:

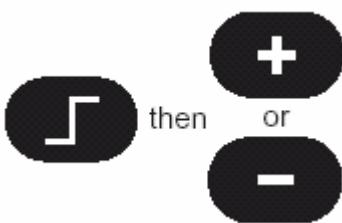


Krátce stiskněte tlačítko mezí alarmů, aby jste se dostali do Menu limitů a poté tlačítka plus a minus k nastavení hodnot.

- Nastavení hlasitosti alarmů a tepové frekvence:

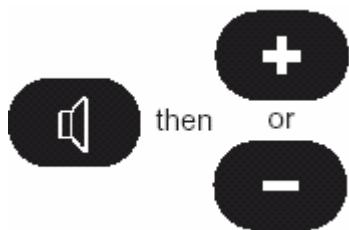

Stiskněte tlačítko hlasitosti a vyberte si chcete-li nastavit hlasitost alarmů nebo tepové frekvence. K nastavení hodnot použijte tlačítka plus a minus.


- Nastavení času a datumu:

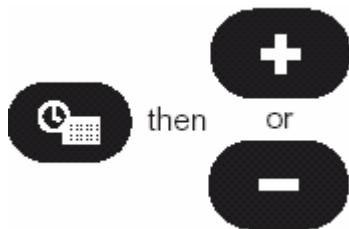

Stiskněte tlačítko času/datumu a poté tlačítka plus a minus k nastavení hodnot.

Pokročilé funkce

- Uchování předchozích hodnot alarmů:



U přístroje v provozu stiskněte současně tlačítka mezí alarmů a minus.

NEBO



+



Při zapínání přístroje držte současně s tlačítkem ON/STANDBY také tlačítko mezi alarmů.

- Zobrazení pacientových záznamů:



+



Při zapínání přístroje držte současně s tlačítkem ON/STANDBY také tlačítko času/datumu.

- Nastavení režimu Patient security



Držte stisknuté tlačítko času/datumu spolu s tlačítkem mezi alarmů po dobu pěti sekund. Stav režimu Patient security je na číselném LED displeji zobrazen zeleně. K jeho změně stiskněte tlačítko hlasitosti (pouze je-li režim zobrazen). Nové nastavení režimu je potom zobrazen žlutě.




3.7 Přepínače přístroje Avant 9600

Avant 9600 má pod zadním krytem osm přepínačů. (Oddělání krytu viz. výměna baterií.)

Horní pozice směruje k vršku přístroje, dolní pak ke spodku. **Tovární nastavení všech přepínačů odpovídá spodní pozici.**

Přepínač č. 1	<i>vyřazení alarmů z činnosti</i> Horní pozice – alarm lze zcela ztišit Dolní pozice – hlasitost alarmu nemůže být nastavena pod 45dB
Přepínač č. 2	<i>normální/pomalé měření průměrů hodnot SpO₂</i> Horní pozice – pomalé měření průměru (každých 8 tepů) Dolní pozice – normální měření průměru (každé 4 tepy)
Přepínač č. 3	<i>funkce alarmů zablokovány/odblokovány</i> Horní pozice – alarmy zablokovány Dolní pozice – alarmy odblokovány
Přepínač č. 4	<i>zamýšleno pro další využití</i>
Přepínač č. 5	<i>US / mezinárodní formát datumu</i> Horní pozice – mezinárodní formát datumu Dolní pozice – US formát datumu
Přepínač č. 6	<i>šetření energie – ztlumení jasu displeje při bateriovém provozu</i> Horní pozice – šetření energie deaktivováno Dolní pozice – šetření energie aktivováno
Přepínač č. 7	<i>výstup pro připojení k nemocničnímu komunikačnímu systému</i> Horní pozice – plynulé Dolní pozice – krátkodobé
Přepínač č. 8	<i>pacientovy záznamy v reálném čase</i> Horní pozice – okamžité zobrazení na pacientova tepu a hodnot SpO ₂ Dolní pozice – zobrazení tepu a hodnot SpO ₂ podle funkce přepínače č. 2

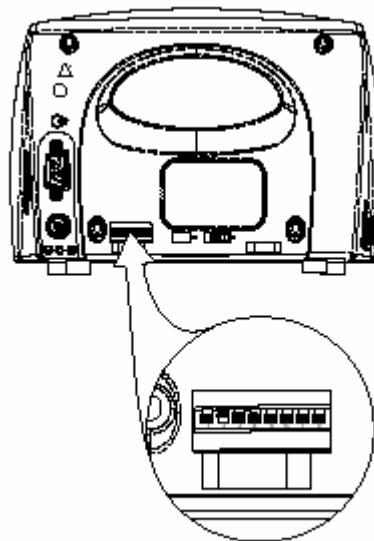


3.8 Komunikační funkce

Přístroj Avant 9600 je vybaven komunikační funkcí, která umožňuje připojit přístroj na nemocniční komunikační systém, a tím přivolat zdravotnický personál. Avant 9600 při spuštění alarmu vyšle signál do nemocničního systému.

Přepínač číslo 7 (viz. kapitola 3.6) umožňuje uživateli vybrat si délku trvání tohoto signálu. Je-li přepínač v horní pozici, pak se ozve pouze jednosekundový signál, a to okamžitě po spuštění alarmu. Je-li přepínač v dolní pozici, pak je signál zapnut po stejnou dobu jako alarm přístroje.

Komunikační funkce obsahuje přepínač – umístěn pod zadním krytem – který umožňuje uživateli vybrat si jestli bude trvale otevřen (NO – přepínač na levé straně) nebo trvale zavřen (NC – přepínač na pravé straně).

Tato funkce může být používána jak při napájení přístroje přímo ze sítě el.energie, tak i z baterií

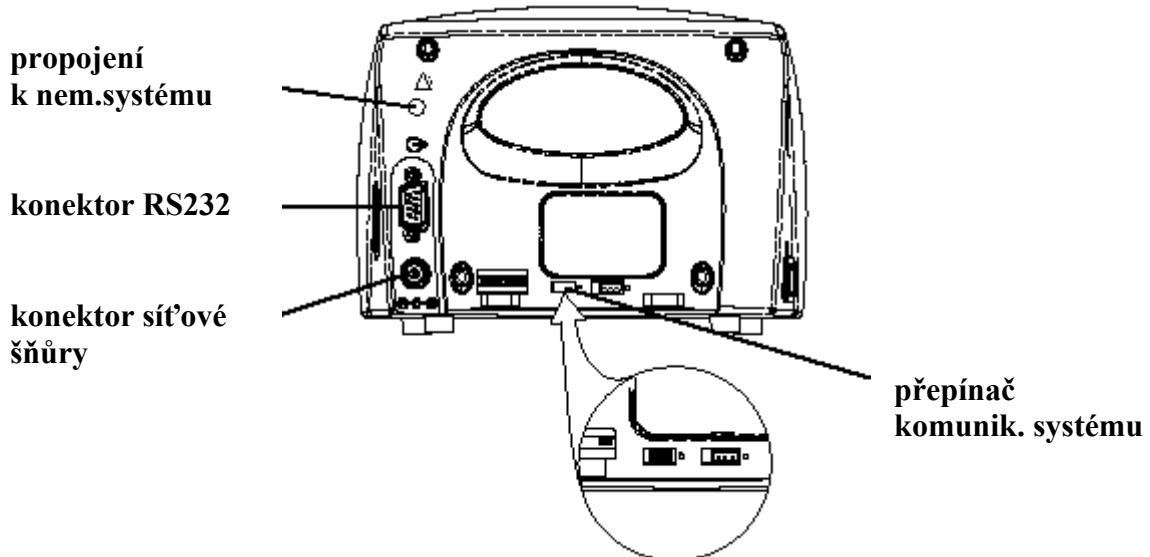

Druh přenosu	Normální provoz	Alarm	Vypnuto
NO-trvale otevřen	otevřen	zavřen	otevřen
NC-trvale zavřeno	zavřen	otevřen	zavřen

DŮLEŽITÉ: Je na uživatelově zodpovědnosti zkontolovat propojení mezi Avant 9600 a nemocničním systémem a přesvědčit se, že komunikační funkce je provozuschopná.

3.9 Ošetřování a údržba

Digitální systém pulsního oxymetru nevyžaduje žádnou kalibraci nebo periodickou údržbu kromě výměny baterií.

Opravy mimo autorizovaný servis nejsou možné. Neotevřejte přístroj, neopravujte elektroniku. V opačném případě se ztrácí nárok na záruku. V případě potíží viz. 10. kapitola - Průvodce možnými problémy str.24.

Čištění přístroje

DŮLEŽITÉ! Nevkládejte přístroj do tekutin a nepoužívejte žíraviny nebo abrazivní čisticí prostředky.

Přístroj čistěte odděleně od příslušenství – senzorů. Čištění senzorů je popsáno v letáku přikládaném přímo k senzorům. Přístroj čistěte jemnou látkou navlhčenou isopropyl alkoholem. Nelijte ani nestříkejte na přístroj tekutiny. Přístroj musí zůstat suchý.

DŮLEŽITÉ! Jestliže se přístroj náhodou navlhčí, odpojte jej od sítě el. energie a nechte oschnout nejméně po dobu jedné hodiny. Měkkou látkou otřete přední panel nebo tělo přístroje

Kapitola 4. Alamy a limity

4.1 Alamy vysoké a střední priority

Avant 9600 má dva druhy alarmů – vysoké a střední priority. A to jak zvukové, tak vizuální.

Alamy vysoké priority

Alamy vysoké priority jsou takové, které vyžadují okamžitou pozornost směrem k pacientovi.

Alamy vysoké priority jsou indikovány červeně blikajícími displeji vždy, když jsou limity alarmů dosaženy nebo překročeny. Navíc, dojde-li k nízkému prokrvení, může se rozsvítit část sloupcového grafu pulsů červeně.

Alamy vysoké priority zní následovně : „píp, píp, píp“ (krátká pauza) „píp, píp“ (10 sekundová pauza).

Alamy střední priority

Alamy střední priority jsou takové signály, které indikují případný problém s přístrojem, nebo jiné život neohrožující situace.

Alamy střední priority jsou indikovány pomale blikajícím žlutými displeji.

Alamy střední priority zní následovně : „píp, píp, píp“ (25 sekundová pauza) „píp, píp, píp“.

4.2 Informační tóny

Informační tóny nám sdělují důležité informace týkající se provozu přístroje. Nikdy však nehlásí naléhavou výstrahu.

Typickými tóny jsou jedno či tři pípnutí. Jsou slyšet například při zapnutí přístroje. Signalizují také každý puls.

4.3 Kódy chyb

Avant 9600 poskytuje uživateli prostřednictvím různých kódů informace o možných problémech.

K odstranění možných chyb prosím postupujte takto:

- 1) Vypněte a zapněte přístroj pro odstranění chyby.
- 2) Je-li kód stále zobrazen na displeji, vypojet a následně opět připojte všechny zdroje energie (baterie či el. energii ze sítě).
- 3) Přetravává-li problém, obrátěte se na dodavatele.

4.4 Přehled alarmů

Následující přehled poskytuje informace vztahující se k nastavení alarmů, jejich limitů. Jestliže jsou limity dosaženy nebo překročeny, přístroj aktivuje příslušný alarm.

Typ limitu	Nastavení výrobce	Nastavitelný rozsah
SpO ₂ dolní mez	vypnuto	vypnuto, 80 až 100, po 1%
SpO ₂ horní mez	80%	vypnuto, 50 až 95%, po 1%
Srdeční frekvence – horní mez	200 pulsů/min.	vypnuto, 75 až 275, po 5 pulsech/min.
Srdeční frekvence – dolní meze	50 pulsů/min.	vypnuto, 30 až 100, po 5 pulsech/min.

4.5 Nastavení a změny hlasitosti a limitů alarmů

DŮLEŽITÉ: Vždy při zapnutí přístroje se automaticky aktivují hodnoty nastavené výrobcem. Pokud ovšem není nastraven režim Patient security. (viz. kap. 4.8)

Prohlížení, nastavování a měnění mezí alarmů jednotlivých vitálních funkcí

- 1) Přesvědčte se, že je přístroj správně zapnut.
- 2) Stiskněte tlačítko mezí alarmů. Vedle tohoto tlačítka jsou kulaté LED displeje označující horní a dolní meze limitů pro SpO₂ (rozsvítí-li se horní displej, jedná se o horní mez a naopak). Tlačítko tedy stiskněte tolikrát až se rozsvítí indikátor meze kterou chcete nastavit a na displeji se zobrazí její momentální hodnoty.
- 3) Použitím tlačítek plus (+) a minus (-) nastavte požadované hodnoty.

Prohlížení, nastavování a měnění hlasitosti alarmů

- 1) Přesvědčte se, že je přístroj správně zapnut.
- 2) Stiskněte tlačítko hlasitosti – jednou pro změnu hlasitosti alarmů
- dvakrát pro změnu hlasitosti tepové frekvence
Zároveň se na obrazovce objeví momentální hodnoty hlasitostí.
- 3) Použitím tlačítek plus (+) a minus (-) nastavte požadované hodnoty.

4.6 Deaktivace alarmů

Všechny zvukové alarmy mohou být deaktivovány po dobu dvou minut stlačením tlačítka ztišení alarmů. Visuální indikace alarmů nemůže být vypnuta.

Pro trvalé deaktivování zvukových alarmů je třeba, aby přepínač č. 1, který se nachází pod zadním krytem přístroje, byl přepnut v horní pozici. Potom je možné nastavit hlasitost na 0. (viz. 3.6 – Přepínače přístroje Avant 9600)

4.7 Blokované a neblokované alarmy

Blokované alarmy – Alarmy budou dále v aktivní i po pominutí situace díky níž byly aktivovány. Vypnout se musí tlačítkem ztišení alarmů.

Neblokované alarmy – Alarmy budou aktivní jen po dobu trvání situace díky níž byly aktivovány.

Pro nastavení blokovaných či neblokovaných alarmů je třeba nastavit přepínač č. 3, který se nachází pod zadním krytem přístroje, do požadované pozice. V horní pozici budou alarmy blokovány, v dolní pak odblokovány.

(viz. 3.6 – Přepínače přístroje Avant 9600)

4.8 Režim Patient security

Režim Patient security je stav přístroje, v němž nelze změnit žádné nastavení přístroje, a v němž může být zobrazeno pouze nastavení hodnot mezí alarmů.

Při zapínání tohoto režimu na displeji třikrát žlutě „**|||||**“ blikne a ozve se informační tón – tři krátké zapípání. Poté se na displeji zobrazí horní hranice mezí alarmů a následně i dolní hranice mezí alarmů.

DŮLEŽITÉ: Tento mod není funkční, je-li Avant 9600 vypnuto.

Nastavování režimu Patient security

1.) Stiskněte současně tlačítka nastavení mezí a tlačítka času/datumu a držte po dobu pěti sekund. Na displeji se na moment zobrazí stav tohoto modu:

“**|||||**” režim je aktivován

“**000 000**” režim není aktivován

2.) Pro změnu stavu režimu stiskněte po dobu jeho zobrazení tlačítko hlasitosti. Nový stav se žlutě zobrazí na dvě sekundy.

DŮLEŽITÉ: Nastavení mezí alarmů nemůže být změněno, je-li režim aktivní. Takto přístroj zamezuje jejich náhodným změnám na kritické hodnoty.

Kapitola 5. Komunikace

5.1 Paměť

Přístroj může uchovávat data měření SpO2 a srdeční frekvence až po dobu 115 hodin. Pro zpracování těchto dat je určen Software nVision.

Paměť přístroje funguje jako nekonečný pásek. Když je paměť zaplněna, nejnovější data přepisují data nejstarší.

Vždy, když je přístroj zapnut, se do paměti uchovává také čas a datum (musí být správně nastaveno) a začíná se nahrávat nová sekce.

Data SpO2 a srdeční frekvence jsou sbírány a uchovávány každé 4 vteřiny. Hodnoty SpO2 jsou uchovávány v přírůstcích 1% v rozsahu 0 až 100%, data srdeční frekvence v rozsahu 18 až 300 pulsů/min. V rozsahu 18 až 200 pulsů/min jsou pulsy ukládány v přírůstku jednoho pulsu/min, v rozsahu 201 až 300 pulsů/min v přírůstku dvou pulsů/min.

POZNÁMKY: Vždy, když je přístroj zapnut, se data automaticky ukládají do paměti. Pouze záznamy delší než jedna minuta jsou ukládány do paměti. Přehrávání, vyvolávání dat z paměti tyto data nemaže.

5.2 Použití softwaru nVision

Přístroj má paměť, která umožňuje uchovávat data k přenosu na software nVision. Použijte následující postup ke spolupráci přístroje a software nVision.

- 1.) Propojte RS-232 port na přístroji s PC. Přístroj je přitom vypnutý.
- 2.) Přístroj nechte stále vypnutý a stlačte a držte tlačítko času/datumu. Současně stlačte tlačítko ON/STANDBY. Všechny displeje se krátce rozsvítí, a na displejích SpO2 a tepové frekvence se objeví "PLy", a "bAC". To vše signalizuje mod přehrávání přístroje.
- 3.) Symboly "PLy bAC" se po několika vteřinách ztratí, čímž je signalizováno dokončení přehrávání paměti. (Přehrávání velkých souborů může trvat až 8 minut.) Stlačením tlačítka ON/STANDBY se ukončí mod přehrávání.
- 4.) Symbol "CLr no" se zobrazí a zazní tři informační tóny.
- 5.) Pouze chcete-li vymazat paměť
Použijte tlačítka plus nebo minus pro zobrazení symbolu "CLr YES".
Stiskněte ON/STANDBY. K potvrzení vymazání paměti vyberte tlačítka plus nebo minus symbol "dEL YES". Znovu stiskněte ON/STANDBY.
"dnE CLr" potvrdí, že je paměť vymazána.
- 6.) Stiskněte ON/STANDBY pro návrat k normální činnosti přístroje.

5.3 Výstup dat v reálném čase

Přístroj umožnuje výstup dat v reálném čase přes RS 232 port. Modemový kabel slouží k propojení s PC.

Informace z Avant 9600 jsou v reálném čase odesílány v ASCII formátu rychlostí 9600 baud a 9 data bit, 1 start bit, 1 stop bit, a to jedenkrát za sekundu.

Po zapnutí je odeslána hlavička identifikující formát, čas a datum. Poté jsou data oxymetrem jedenkrát za sekundu posílána v následujícím formátu :

Pokud je přepínač č.8 v horní pozici, data budou zobrazena:

SPO2=XXX HR=YYY F

Kdy XXX a YYY jsou momentální hodnoty nasycení krve a tepové frekvence.

Pokud je přepínač č. 8 v dolní pozici, data budou zobrazena:

SPO2=XXX HR=YYY

Kde XXX a YYY jsou zobrazeny podle stavu přepínače č. 2

(viz. 3.6 – Přepínače přístroje Avant 9600)

Kapitola 6.

Teorie provozu

Pulsní oxymetr prosvěcuje tkáň červeným a infračerveným zářením. Detekuje pulsující signály, které jsou vyvolány pulsováním krve v tepnách. Poměr dvou obdržených barevných signálů určuje objem saturace krve kyslíkem. Dobře okysličená krev je jasně červená. Málo okysličená krev má tmavě červenou barvu. Stálé podmínky (ustálené proudění krve v žilách, tloušťka kůže, nehet, apod.) nevyvolávají kolísání intenzity světla, které prochází tkání. Nemají tedy vliv na měření saturace. Avšak jestliže se přes tkáň dostane příliš málo světla, nebo buse-li puls nedostačující, přístroj nebude schopen určit hodnoty.

Pulsní oximetr pracuje se dvěma různými vlnovými délками světla. Má tedy schopnost určit jednu složku krve. Avavnt 9600 je nastaven tak, že approximuje funkční hodnoty saturace. Hodnoty naměřené těsně approximují hodnoty, které jsou získané přesnými laboratorními přístroji v případě, že je zanedbatelná hladina nefunkčního hemoglobinu v krvi.

Oxymetr ignoruje množství karboxyhemoglobinu v krvi. Nadměrné hodnoty medhemoglobinu však mohou měření přístroje vychýlit až o 85%.

Displej přístroje se obnovuje každou 1 či 1/2 sekundy. Hodnoty na něm zobrazené tedy nikdy nejsou starší než 30 sekund.

Kapitola 7. Specifikace

Pulsní oxymetr

Rozsah SpO₂ 0% to 100%

Rozsah srdeční frekvence 18 až 300 pulsů za minutu

Displays

Číselné displeje 3-číslicové LEDky, tříbarevné (červená, zelená, žlutá)
Indikátor pulsů trojbarevné LED dílky

Přesnost

Nasycení krve kyslíkem 70% to 100% \pm 2 číslice
Srdeční frekvence \pm 3% \pm 1 číslice

Měřicí vlnové délky a výstup

Červená 660 nanometrů @ 3 mw
Infračervená 910 nanometrů @ 3 mw

Nadmořská výška

Provozní nad. výška Do 12000 m n.m.

Systém

Teplo

Provozní +0° až +50°C
Skladovací/dopravní -20° až +50°C

Vlhkost

Provozní 10% až 90% nekondenzující
Skladovací/dopravní 10% až 95% nekondenzující

Zdroj el. energie

7.2 V baterie (6 článků) nebo 12 V DC/AC Adapter

Životnost baterií

Provozní minim 12 hodin souvislého provozu
Skladovací 27 dní
Nabíjení 4 hodiny

Rozměry 11, 4 x 18,4 x 14 cm

Hmotnost 1 kg včetně baterií

Paměť minimálně 115 hodin

Klasifikace dle IEC 60601-1 / CSA601.1 / UL2601-1

Typ ochrany Třída I (když zapojeno AC adapterem a 300PS-UNIV universálním nabíječem baterií)

Třída II (když zapojeno AC adapterem s jiným nabíječem baterií)

Vnitřní zdroj (bateriový)

Stupeň ochrany typ BF, odolné defibrilátoru

Komunikační funkce

Maximální napětí 30V, AC/DC adapter

Maximální napájení 20mA

Výstupní odpór 320 ohmů

Výstup otevřený či zavřený – nastavitelné přepínačem
(viz. 3.6 přepínače přístroje Avant 9600)

Výstupní konektor 3,5 mm jack

Kapitola 8.

Díly a příslušenství

Objednací číslo	Název/popis
2120 B	Baterie
9600 manual	Uživatelská příručka
300PS-EU	Nabíječka baterií, Evropa
300PS-UNIV	Nabíječka baterií, stolní, univerzální s konektorem IEC320
Externí kabely	
UNI-RA-0	Prodlužovací kabel k senzorům (19cm, úhel 90°)
8500I	Prodlužovací kabel k senzorům (1 metr)
8500VI	Prodlužovací kabel k senzorům (3 metry)
8604X-20	Prodlužovací kabel k senzorům (6 metrů)
8604X-30	Prodlužovací kabel k senzorům (9 metrů)
8600NC-6	Kabel k napojení na nemocniční komunikační systém (2 metry)
8600NC-10	Kabel k napojení na nemocniční komunikační systém (3 metry)
8600NC-10X	Kabel k napojení na nemocniční komunikační systém (3 metry bez zásuvky)
UNI-RS232	Kabel RS-232
Senzory na opakování použití	
8000AA-1	Prstový senzor pro dospělé (1 metr)
8000AA-3	Prstový senzor pro dospělé (3 metry)
8000AP-1	Dětský prstový senzor (1 metr)
8000AP-3	Dětský prstový senzor (3 metry)
8000J	Flexibilní senzor pro dospělé (1 metr)
8000J-3	Flexibilní senzor pro dospělé (3 metry)
8008J	Dětský flexibilní senzor
8001J	Flexibilní senzor pro novorozence
8000Q	Ušní senzor
8000R	Odrazový senzor
Senzory na jedno použití	
7000A	Flexibilní prstový senzor pro dospělé, 10ks v balení
7000P	Dětský flexibilní prstový senzor, 10ks v balení
7000I	Flexibilní palcový senzor pro kojence, 10ks v balení
7000N	Flexibilní senzor pro novorozence na chodidlo, 10 ks v balení
Jiné vybavení	
nVision	Software nVision pro Windows 95/98/2000
8000JFW	Připevňovací pánska k senzoru 8000J
8008JFW	Připevňovací pánska k senzoru 8008J
8001JFW	Připevňovací pánska k senzoru 8001J
8000H	Držák k odrazovému senzoru
8000S	Simulátor provozu oxymetru

Kapitola 9. **Servis a údržba**

DŮLEŽITÉ! Přístroj je jemné elektronické zařízení a opravován může být pouze vyškolenou osobou.

Modul pulsní oxymetrie přístroje provádí všechny výpočty interním software, který je uložen na mikroprocesoru. Nedochází proto k žádným odchylkám a není potřeba modul oxymetrie kalibrovat.

Informace o přístroji a příslušenství se dozvítě od Vašeho místního dovozce/prodejce nebo Nonin Medical na adresě :

Nonin Medical, Inc.
2605 Fernbrook Lane North
Plymouth, Minnesota 55447-4755 USA
Tel 001 763 553-9966
Fax 001 763 553-7807
mail@nonin.com
www.nonin.com

NONIN MEDICAL INCORPORATED (NMI) ručí zákazníkovi po dobu tří let od data doručení za modul pulsní oxymetrie, jeden rok za baterie. Po dobu 90 dnů od data doručení se vztahuje záruka na kabely a senzory. NMI opraví všechny systémy nebo příslušenství, které byly shledány vadnými ve shodě s textem této záruky, bezplatně. Tato záruka vyjímá náklady na dopravu.

Oxymetry a příslušenství jsou citlivé a musí být opravovány pouze člověkem znalým a speciálně zacvičeným. Jakákoli známka nebo svědectví toho, že přístroj byl otevřen jinou osobou a tímto poškozen, nebo jestliže byl oxymetr či příslušenství špatně a nesprávně používány, zapříčiňuje ztrátu záruky.

Všechny pozáruční opravy budou provedeny podle NMI sazeb, které jsou platné v době doručení přístroje do NMI.

Kapitola 10. **Průvodce možnými problémy**

Následující přehled podává informace o možných problémech spojených s provozem přístroje, možné důvody těchto potíží a možnosti jejich nápravy.

Problém

Možná příčina

Možná náprava

Přístroj nefunguje na baterie

Baterie jsou nesprávně vloženy.

Zkontrolujte, napravte.

Baterie jsou vybité.

Vložte AC adapter pro jejich nabítí.

Baterie nefungují.

Kontaktujte dodavatele.

Světlo sloupcového grafu nesvítí zeleně.

Puls pacienta je slabý.

Vyměňte používaný prst za jiný a podržte senzor 10 vteřin bez pohybu.

Zahřejte pacientův prst třením, přikrytím.

Přemístěte senzor(např. na ušní lalůček).

Cirkulace krve je omezena díky vnějšímu tlaku na senzor.

Dejte prst na měkkou podložku, aby k tlaku nedocházelo.

Prst je studený.

Zahřejte prst třením, přikrytím.

Přemístěte senzor (např. na ušní lalůček).

Senzor oxymetru je nesprávně použit.

Nasadte senzor na prst správně.

Mohou zde být další možné překážky jako:

- srdeční katetr
- tlaková manžeta
- šňůra od infuze

Odstraňte či redukujte možné nedostatky.

Přesvědčte se, že oxymetr není používán na stejně ruce jako další přístroje (tlaková manžeta atd.)

Na vnitřní straně senzoru nesvítí červené světlo.

Zkontrolujte jestli je senzor správně napojen na přístroj.
Kontaktujte prodejce.

Přístroj ukazuje stejnou tepovou frekvenci

Nadměrné okolní světlo. Ochraňte senzor před světlem.

Senzor je umístěn na Použijte prst bez uvedeného.
nalakovaný nebo umělý nehet.

Prst je studený. Ohřejte prst třením, přikrytím.

Prst je vlhký. Osušte prst i vnitřní povrch senzoru.

Pohyb pacienta je nadměrný. Snižte pohyb pacienta.

Na displeji nasycení krve (SpO_2) se objeví pomlčka (-)

Z prstu je získán slabý signál. Vložte do senzoru jiný prst a nechte ho po dobu 10 sekund nehybným.

Přemístěte senzor (např. na ušní lalůček).

Senzor není na prstu. Vložte prst do senzoru a nechte ho po dobu 10 sekund nehybným.

Přístroj nefunguje. Vypněte ho, zkontrolujte všechna zapojení a znova ho zapněte.

Kontaktujte prodejce.

Chybové kody se objeví na displeji.

V přístroji nastala chyba. Viz kapitola 4.3 str.16

Přístroj je v modu alarmů, ale zvukový alarm není slyšitelný.

Tlačítko dvouminutového Stlačte tlačítko k jeho deaktivaci nebo počkejte dvě minuty
ztištění alarmu je aktivováno.

Přepínač č. 1 je v horní (on) Nastavte přepínač č.1 do OFF (dolní) pozice
poloze a hlasitost alarmů je proto nulová.

Prodejce ČR:

COMPEK MEDICAL SERVICES, s.r.o.

17. listopadu 861, 506 01 JIČÍN

Tel./fax: +420 493 524 534

GSM: +420 605 281 433

e-mail: info@compek.cz

Internet: www.compek.cz

E-shop: www.tonometr.cz

Prodejce SK:

COMPEK MEDICAL SERVICES, s.r.o.

Strážná 11, 831 01 Bratislava

GSM: +421 908 758 793,

Fax.: +421 317 855 921

e-mail: info@compek.sk

Internet: www.compek.sk

E-shop: www.tonometer.sk